

整形外科用手術台

DR-6500

more simple process



整形外科用手術台


DR-6500

more simple process

シンプルなプロセスで、牽引手術ポジションへ。
作業効率を考慮した機能型手術台。

STEP 01

あらかじめ骨盤受と
補助脚板を装着する。

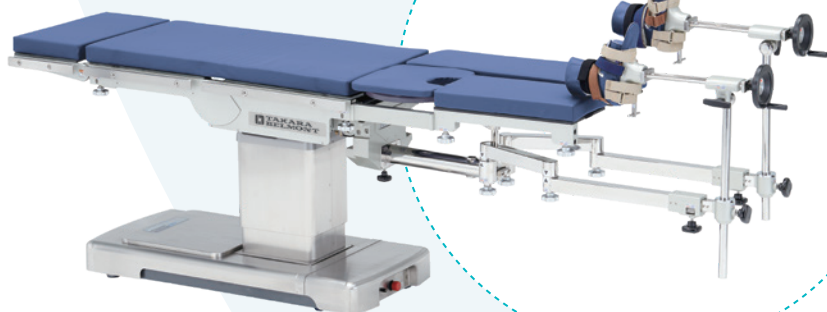

下肢牽引装置 別売
DR-TRAC-A

※別途取付ブラケットが必要です。




牽引装置用カート 別売
DR-6500-B

容易に収納、着脱ができるように配慮
した牽引装置用カート。

STEP 02


脚板を取り付けた状態で、
牽引用ブーツに患者さんの足を固定する。

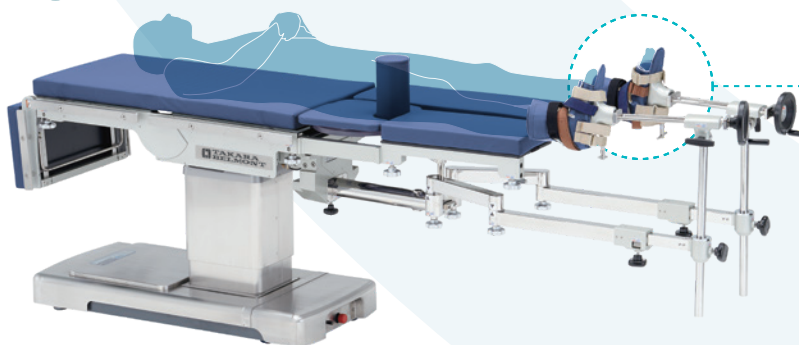

かんたんセッティング
で麻酔導入をサポート

STEP 03

脚板を外し、
牽引アームの調整を行う。

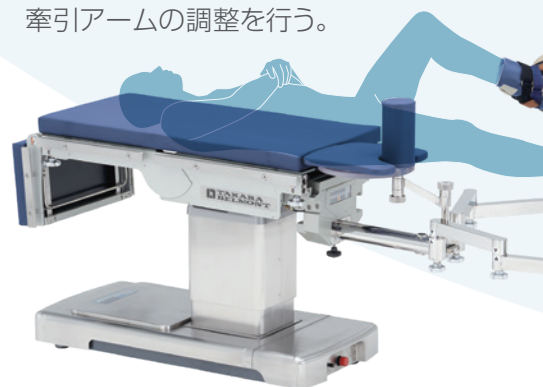




Features

広範囲500mmの昇降範囲

幅広い手術に対応する500mmのワイドストロークを実現。

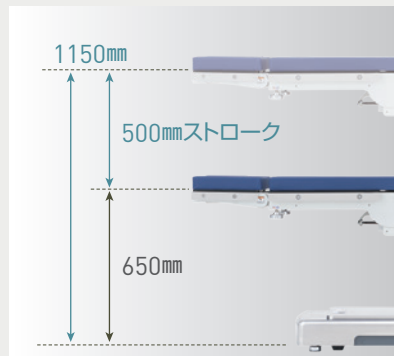

視認性に優れたハンドスイッチ

LEDバックライトを採用し、視認性を向上。発光パターンにより、手術台の状態を操作者に情報発信。




Eスイッチタイマー機能
タイマー機能により操作性を向上。

Eスイッチで
バッテリー残量を表示
● 緑点灯 ... 使用可
● 緑点滅 ... 要充電
● 赤点滅 ... 至急充電
● 赤点灯 ... 使用不可

カセットレール内蔵

半切サイズまで使用可能。



※カセットレーは別売です。


緊急停止スイッチ装備

緊急時や万が一の際に、作動を停止。




本体情報をコントロールパネルに表示

搭載バッテリーの残量状態、テーブルトップアレンジ状態表示、縦横転角度表示など、手術台の状態を情報発信。

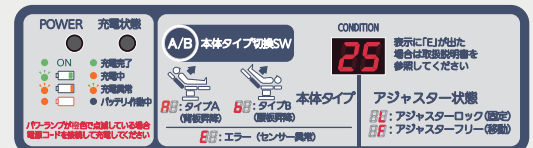

広い透視可能範囲


別売のイメージングエクステンションボードを装着することで、1340mmの透視可能範囲を確保。

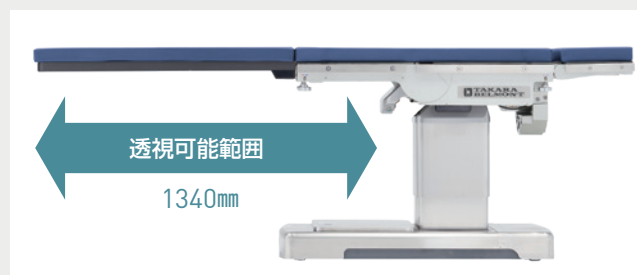

製品コード：DR-OPTM-IMB-2
販売名：イメージングエクステンションボード
製造販売届出番号：28B1X00012000066

Cアームのスムーズな挿入

下肢牽引装置の本体への直接装着により、牽引装置を安定化させる補助支柱が必要ありません。

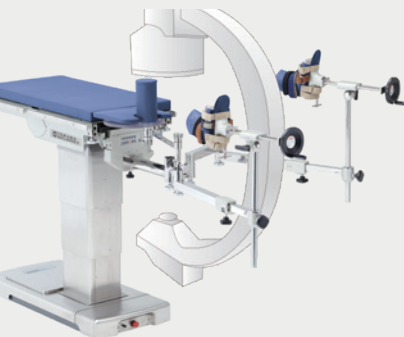

牽引用ブーツ

(下肢牽引装置 装備品)

内旋、外旋、角度調整を別固定方式にし、操作性の向上と的確な固定が容易に。



ホールド性と操作性を向上したC-STRAPシステムを採用！




ストラップをクロスに留めることで、当社従来製品の平行タイプに比べ、足をしっかりとホールド。またストラップごとに色が異なるためベルト固定が容易に。

※イメージ図

Positions

背(腰)板屈折



横転位



縦転位




Accessories

ビーチチェアポジショナー



製品コード：DR-OPTM-BCP
販売名：ビーチチェアポジショナー
製造販売届出番号：27B1X00042005034

透視用上肢台小型



製品コード：DR-OPTM-SIAK/SIBK
販売名：透視用上肢台小型M
製造販売届出番号：28B1X00012000047

上腕ホルダー



製品コード：DR-OPTM-AHZ
販売名：上腕ホルダーM
製造販売届出番号：28B1X00012000042

付属品収納カート



製品コード：DR-OPTM-ACC
さまざまなアクセサリを機能的に収納。

【下肢牽引装置用アクセサリ】

骨盤受(大)



製品コード：DR-TRAC-CG

下腿受(自在)



製品コード：DR-TRAC-CDZ

L型膝関節用ボール



製品コード：DR-TRAC-KNN

側臥位用股間支柱




製品コード：DR-TRAC-CAN

※L型膝関節用ボールと側臥位用股間支柱は別途、取り付けるための共通部品、骨盤受支柱N(DR-TRAC-CGBK)が必要です。


Specifications

[単位(mm)]


【背板屈折仕様】



【腰板屈折仕様】



【下肢牽引装置】

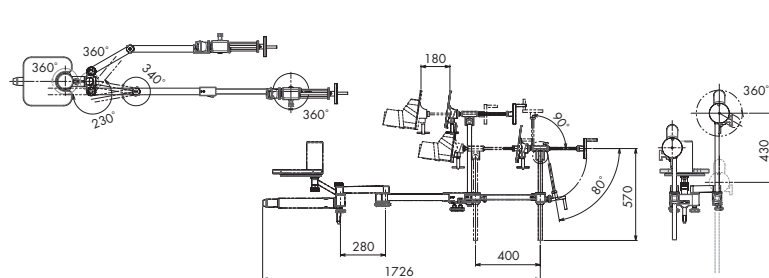

製品コード	DR-6500V
テーブルトップ寸法	500×2063mm
本体質量	330kg
電気定格	AC100V,50/60Hz,6.0A
本体昇降範囲(電動油圧式)	650～1150mm
本体縦転角度(電動油圧式)	頭上方25° 頭下方25°
本体横転角度(電動油圧式)	左肩側上方 25° 右肩側上方 25°
背(腰)板屈折角度(電動油圧式)	上方 75° 下方 40°
枕板屈折角度(手動)	上方 30° 下方 90°
脚板屈折角度(手動)	下方 90°
脚板開脚角度(手動)	左右各 90°
水平停止機能	縦転、横転、背(腰)板動作時
水平復帰機能	縦転、横転、背(腰)板動作時
バッテリー電圧	DC25.2V
電撃に対する保護の形式による分類	クラスI機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	B形装着部
主な構成部品	ハンドスイッチ1個 電源コード1本

■販売名:整形外科用手術台 DR-6500 製造販売届出番号:28B1X00012000076
■販売名:下肢牽引装置 DR-TRAC-A 製造販売届出番号:28B1X00012000078

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年4月現在のものです。

タカラベルモント株式会社

【大阪本社】 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

●メディカル事業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま(048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋(052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takarabelmont.co.jp>